


10 Revise a imagem.




11


Arquive ou exporte as imagens, em seguida encerre o paciente.



12 Remova a bandeja de amostras da cabine de imagem. Siga a política da instalação para manuseio de amostras.

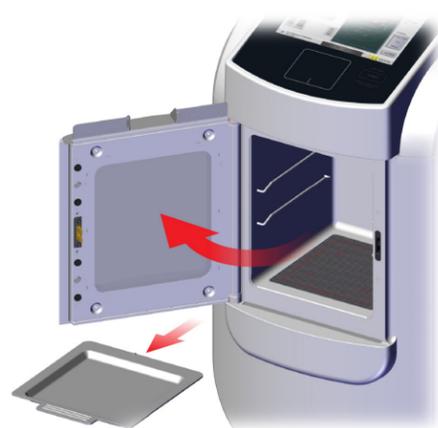

13 Desligue o sistema.

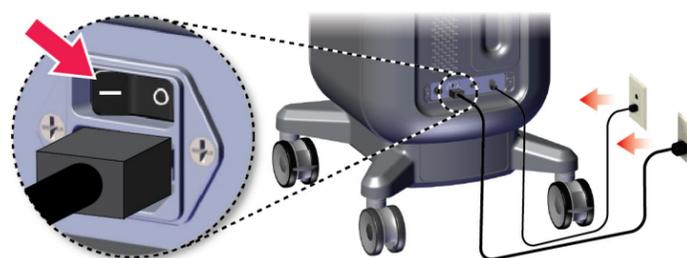

# Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

## Guia de referência rápida



- 1 Monitor de exibição de imagem
- 2 Monitor de controle com Touch pad integrado e Botão de ativação de RAIOS X
- 3 Cabine de imagem

**⚠️ Consulte o Guia do Usuário para informações de segurança y instruções completas.**


- 1 Mova o console para a posição correta.



- 2 Trave os rodízios.



- 3 Conecte o sistema à energia e à rede.



Hologic Inc.  
600 Technology Drive  
Newark, DE 19702 USA  
Tel: +1.800.447.1856



Contacto Imex Medical Group do Brasil  
do Brasil: Rua das Embaúbas, 601- Fazenda  
Santo Antônio  
São José /SC - Brasil - 88104-561  
+55 48 3251-8800  
www.imexmedicalgroup.com.br

**HOLOGIC®**

Visite o nosso website para obter informações sobre as nossas filiais no mundo todo.  
© 2023 Hologic, Inc. Impresso nos EUA. Este manual foi originalmente escrito em inglês.

Hologic, Faxitron, Trident e os logotipos associados são marcas e/ou marcas registradas da Hologic, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as outras marcas, marcas registradas e nomes de produto são de propriedade de seus respectivos proprietários. Este produto pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA ou estrangeiras, conforme identificado em [www.Hologic.com/patents](http://www.Hologic.com/patents).

4 Inicie o sistema e conecte-se.

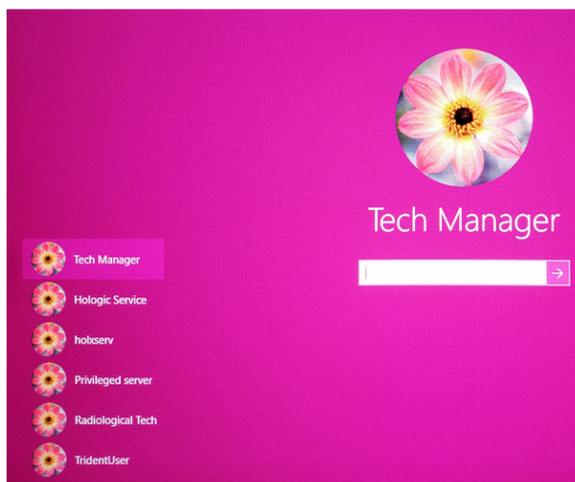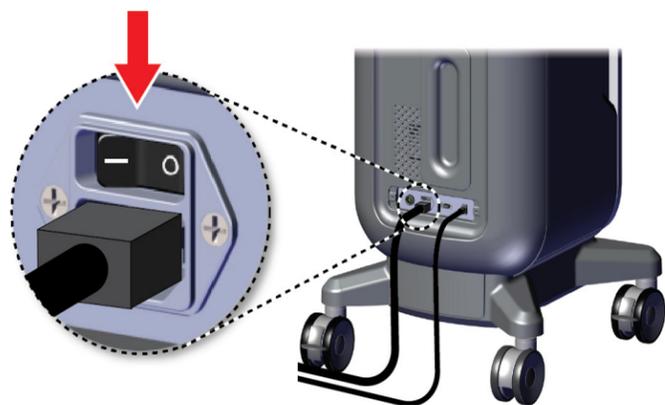


5 Seleccione o paciente e o procedimento.




Nome	Data de nasci...	Exame
Patient^Test	04/02/1979	Specimen, Rig...
Test test^Patient	06/03/1972	Specimen, Left...
Patient patient^Test	08/04/1962	Specimen, Rig...
Test^Patient	02/01/1965	Múltiplo



6 Prepare a amostra de acordo com a política da instalação e centralize a bandeja de amostras.

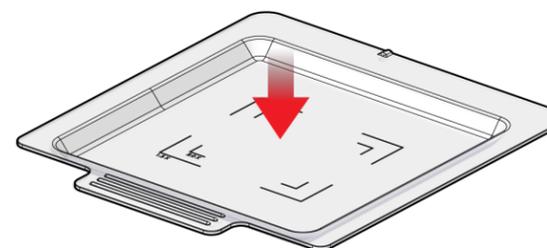

7 Posicione a bandeja de amostras na cabine de imagem para o nível de ampliação necessário.



8 Feche a porta.



9 Adquira a imagem.

